



抗ウイルス・抗菌ボールで練習しよう！

Jトップクリーントレ球

J-TOP CLEAN TRAINING

MADE IN JAPAN

NB-1740 6個入 ￥630 + 税

NB-1744 10ダース(120個入) ￥12,000 + 税

NB-1748 50ダース(600個入) ￥57,000 + 税

硬式40ミリボール



抗ウイルス・抗菌仕様のラージボール公認球

ラージ 3スター クリーン

LARGE 3-STAR CLEAN

MADE IN JAPAN

NB-1640 ￥1,080 + 税

3個入 44ミリボール



抗ウイルス・抗菌仕様のサウンドテーブルテニス用公認球

プラサウンドボール

PLS SOUND BALL

MADE IN JAPAN

NB-1610 ￥1,350 + 税

3個入 40ミリボール ※卓球バレーにも使用できます。



Nittaku®

ニッタクは、安全・安心に卓球を楽しんでいただくために、
抗ウイルス・抗菌加工製品のラインナップ強化に努めています。

練習前や練習後、試合の合間などのお手入れの お悩みは、ニッタクが解決いたします。



このマークが目印です！

ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工
シングルナノ複合粒子コーティング
「メディカルナノコート」

粒径10ナノメートル未満のシングルナノの様々な機能性無機材料を
均一にコーティングする独自技術により表面を清潔に保つ抗ウイルス・
抗菌コーティングです。(第三者機関による、長期間の効果実証データ有り)



Nittaku®


ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工 シングルナノ複合粒子コーティング

「メディカルナノコート」

◆どんな加工技術ナノ？

粒径10ナノメートル未満のシングルナノの様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により
表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティングです。(第三者機関による、長期間の効果実証データ有り)

■ 通常表面とメディカルナノコート(シングルナノ)加工時の比較

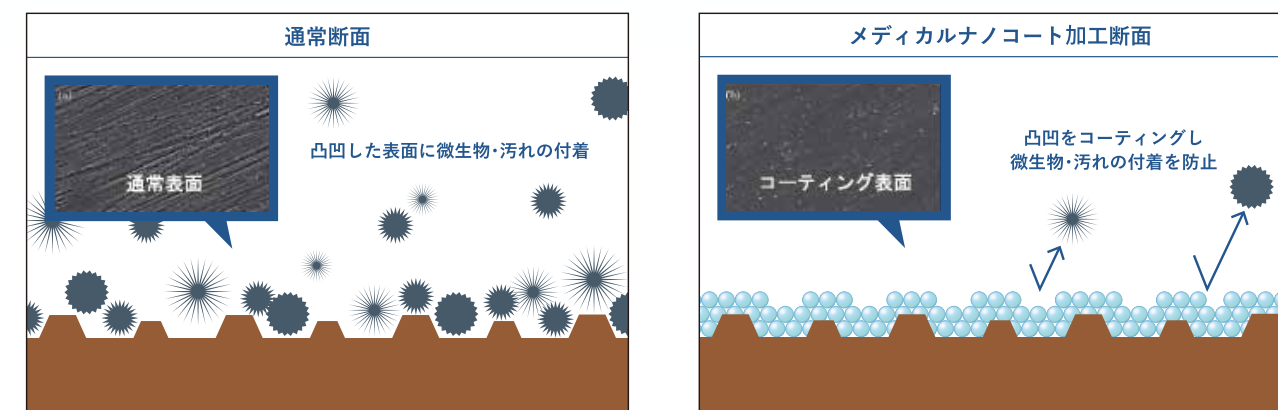


◆ウイルスの主要感染経路の「接触感染」のリスクを軽減！


第三者機関

抗ウイルス性能試験(JISR 1756)

- ・試験機関：地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
- ・試験名：バクテリオファージを用いた抗ウイルス性能評価試験
- ・試験品名：ナスクナノテクノロジー社メディカルナノコート
- ・試験品の種類：メディカルナノコートを塗布したガラス板
- ・試験規格：JIS R 1756: (ISO 18071:2016)を参考

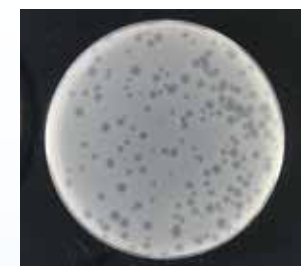

加工無し

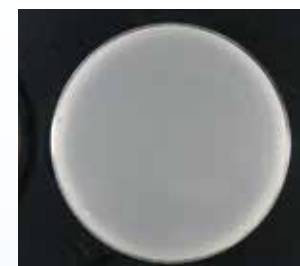

メディカルナノコート

試験の結果、500Luxの明るさの環境下で、
メディカルナノコートを塗布した表面では、
99.9%以上のウイルス減少率を確認しました。

◆お手入れ方法

清潔な布で乾拭きしてください。汚れが付いた場合のお掃除は中性洗剤を使用して水拭きしてください。

ニッタクの抗ウイルス・抗菌加工「メディカルナノコート」 クリーンな環境で卓球を楽しんでもらいたい！